


FFPE 未染からの DNA 抽出ご利用の流れ(学内)

220406ver.

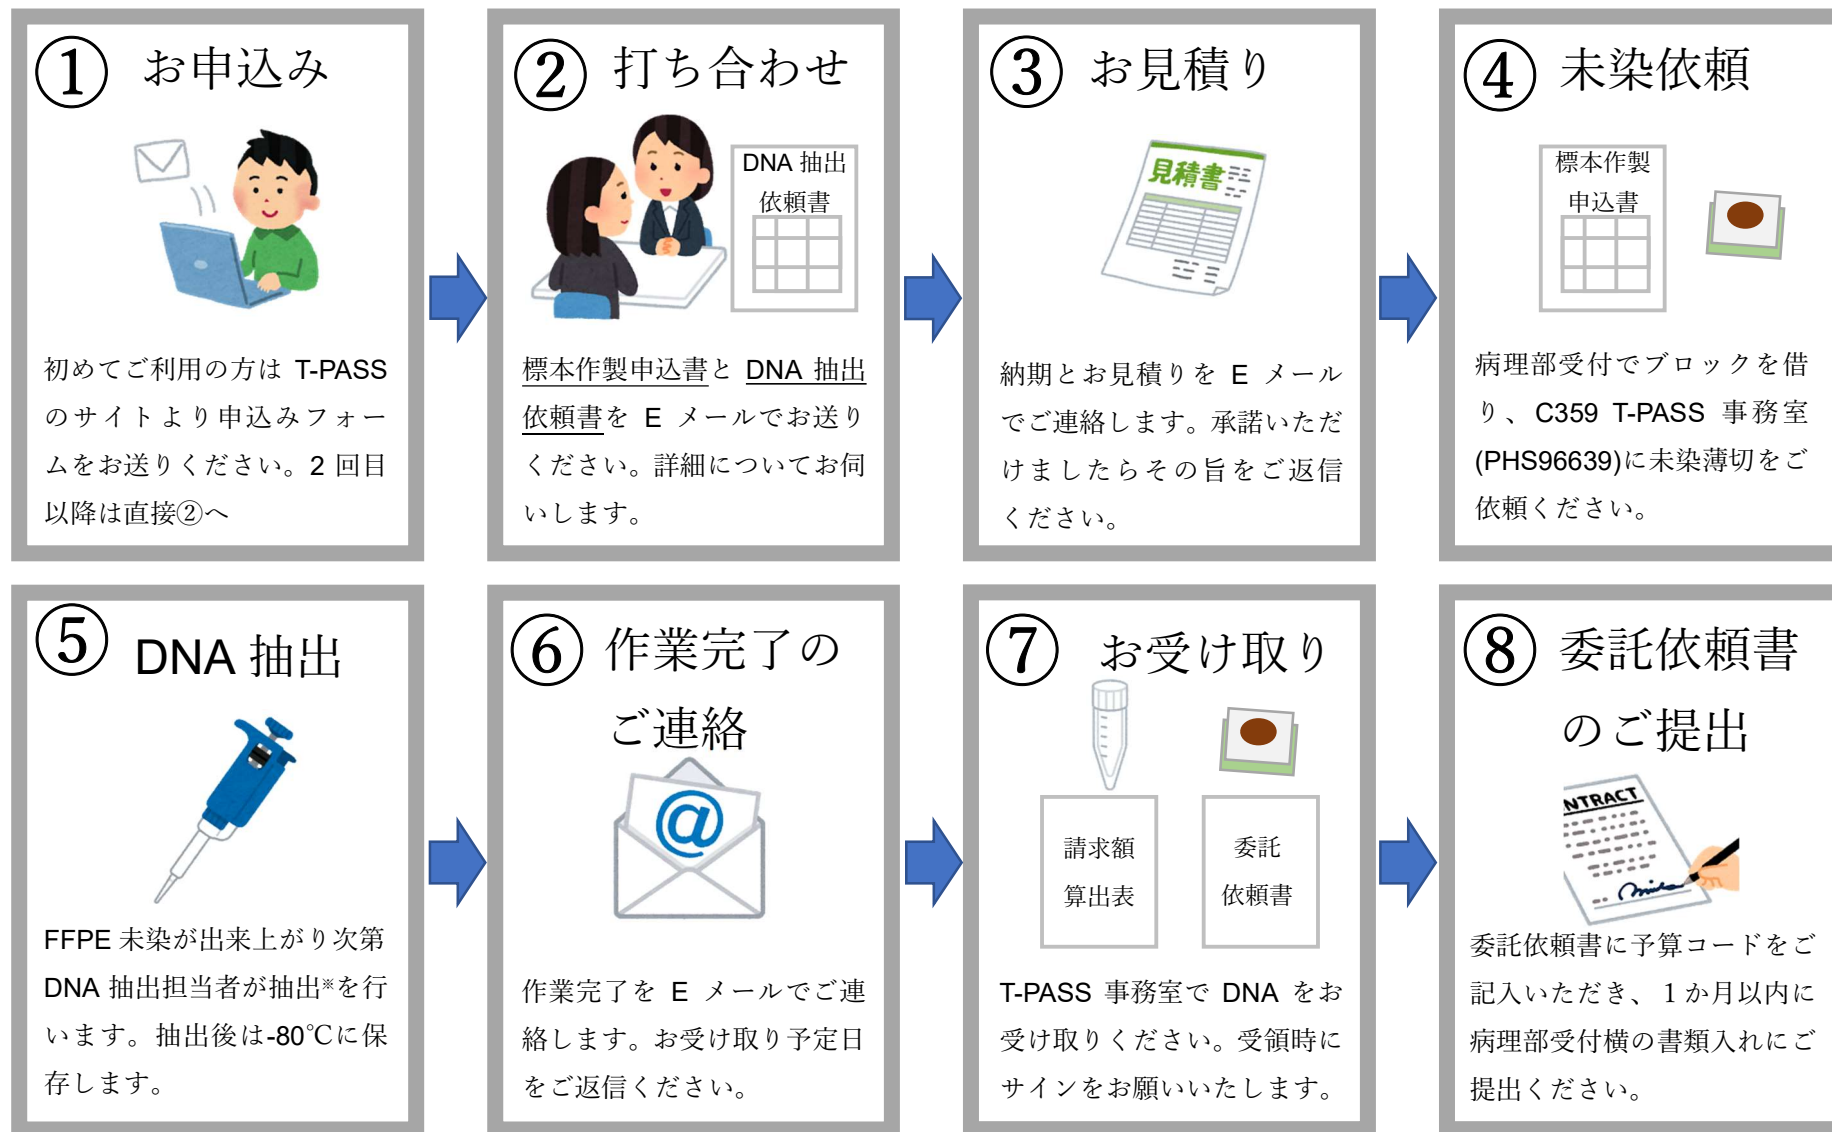

*DNA 自動抽出装置 magLEAD/プレジションシステムサイエンスを使用。溶出は Distilled water 50 μ l。